


Controllo della struttura dell'ortesi sul paziente – dinamico



Se ha risposto a una di queste domande in modo negativo, sono necessarie ulteriori regolazioni. Queste devono essere eseguite sempre sul banco da lavoro, senza indossare l'ortesi!

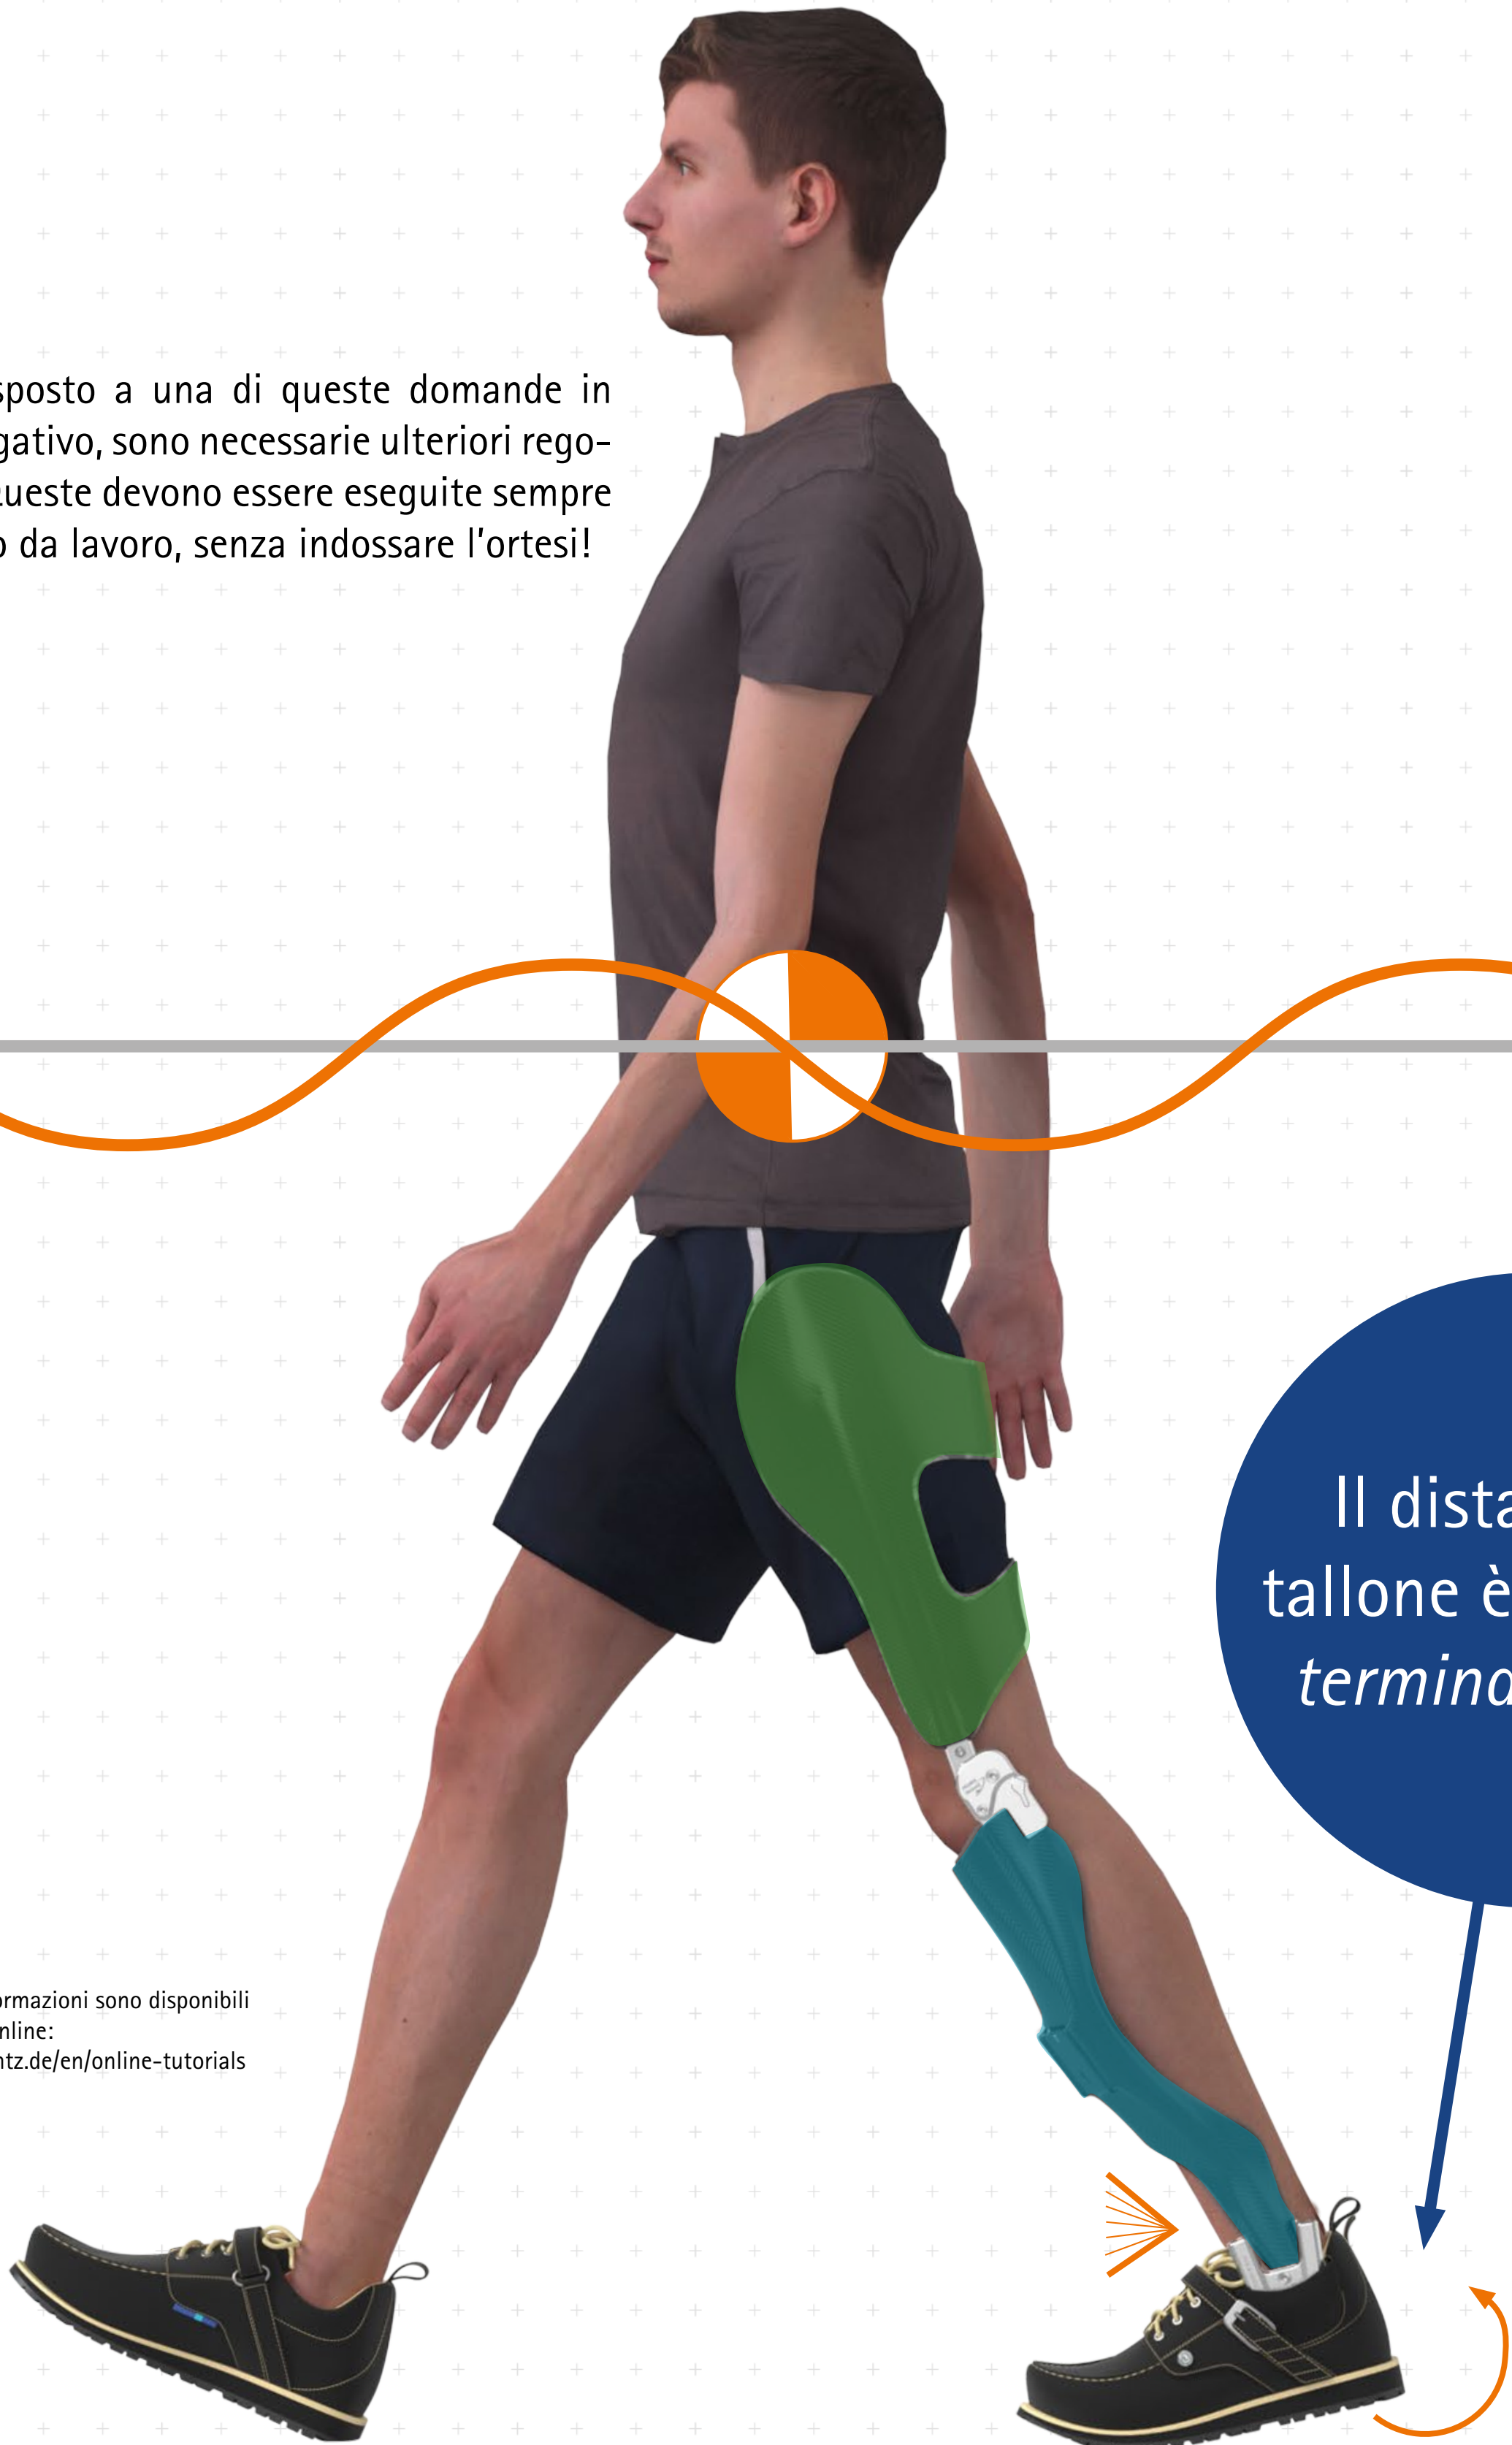

Il distacco del tallone è visibile in *terminal stance*?



Maggiori informazioni sono disponibili nei tutorial online:
www.fior-gentz.de/en/online-tutorials